

Использование ОВП\РН\ Temp – метра ORP-3569

1. Удалить защитный колпачок. Запустить прибор;
2. Окунуть прибор в измеряемую жидкость;
3. Осторожным помешиванием ожидайте стабилизации параметров на дисплее; Не ударяйте электродом по стакану;
4. Для выбора режима измерения нажимайте кнопку рН/ORP, нажимайте C/F кнопку для выбора шкалы Цельсия или Фаренгейта;
5. После использования, выключайте прибор, сполосните электрод в дистиллированной воде для предотвращения загрязнения;
6. Всегда закрывайте электрод защитным колпачком после использования.


КАЛИБРОВКА

I. рН датчика


1. Окуните рН электрод в дистиллированную воду, излишки воды уберите салфеткой;
2. Включите прибор и нажмите кнопку рН/ORP, выберите рН для измерения;
3. Окуните рН электрод в буферный раствор рН 6.86 (или рН 7.00), плавно перемешивайте и ожидайте стабилизации показаний на экране (как показано на рисунке).



4. С помощью отвёртки в комплекте поворачивайте регулятор под крышкой в батарейном отсеке до значения 6.86 (7.00) на дисплее в буферном растворе температуры 25 градусов по Цельсию.

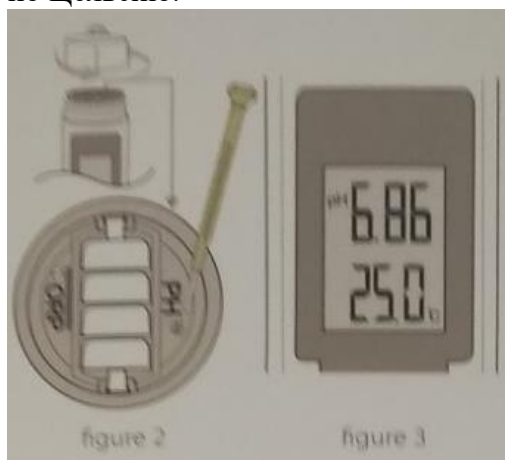

5. Окуните рН электрод в дистиллированную воду и излишки воды уберите салфеткой;
6. Окуните рН электрод в буферный раствор рН 4.01 или рН 9.18 (или рН 10.00), плавно помешивая до стабилизации значений на экране, как показано на рисунке ниже.

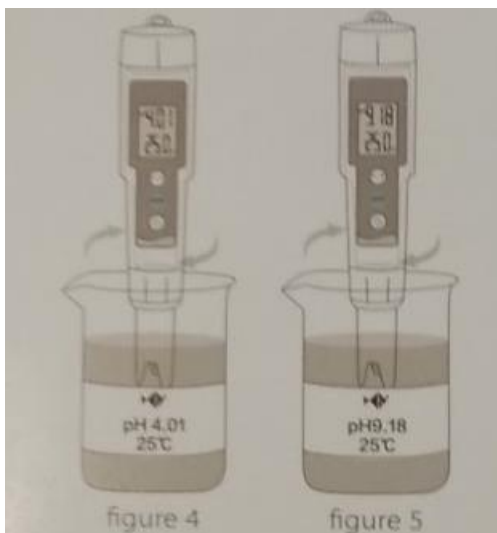

Калибровка pH датчика теперь завершена.


ВАЖНО!

Рекалибровка pH датчика необходимо лишь в следующих случаях:


1. Измерительный прибор очень долго не использовался;
2. Измерительный прибор использовался очень интенсивно, постоянно;
3. Необходимо получить наиболее точные показатели измерения.

II. ORP датчика


1. Включите прибор;
2. Включите прибор и нажмите кнопку pH/ORP, выберите ORP для измерения;
3. Окуните электрод в дистиллированную воду;

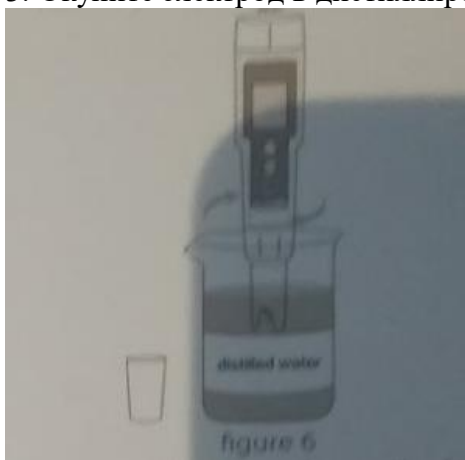

3. Окуните электрод в свежий стандартный раствор 256mV ORP, плавно перемешивайте и ожидайте стабилизации показаний на экране (как показано рисунке).

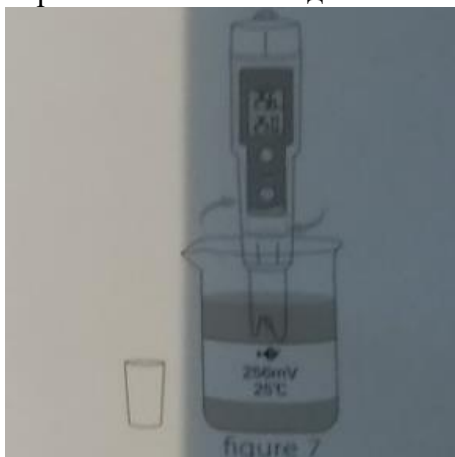

4. С помощью отвёртки в комплекте поворачивайте регулятор под крышкой в батарейном отсеке до значения 256 на дисплее, как показано на рисунке:

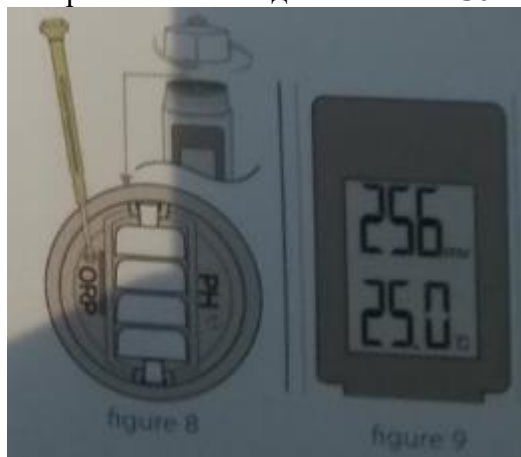

Калибровка ORP датчика теперь завершена.

Составные части и отсеки прибора:

